
Braese, Steffen Otterbach, SOT252

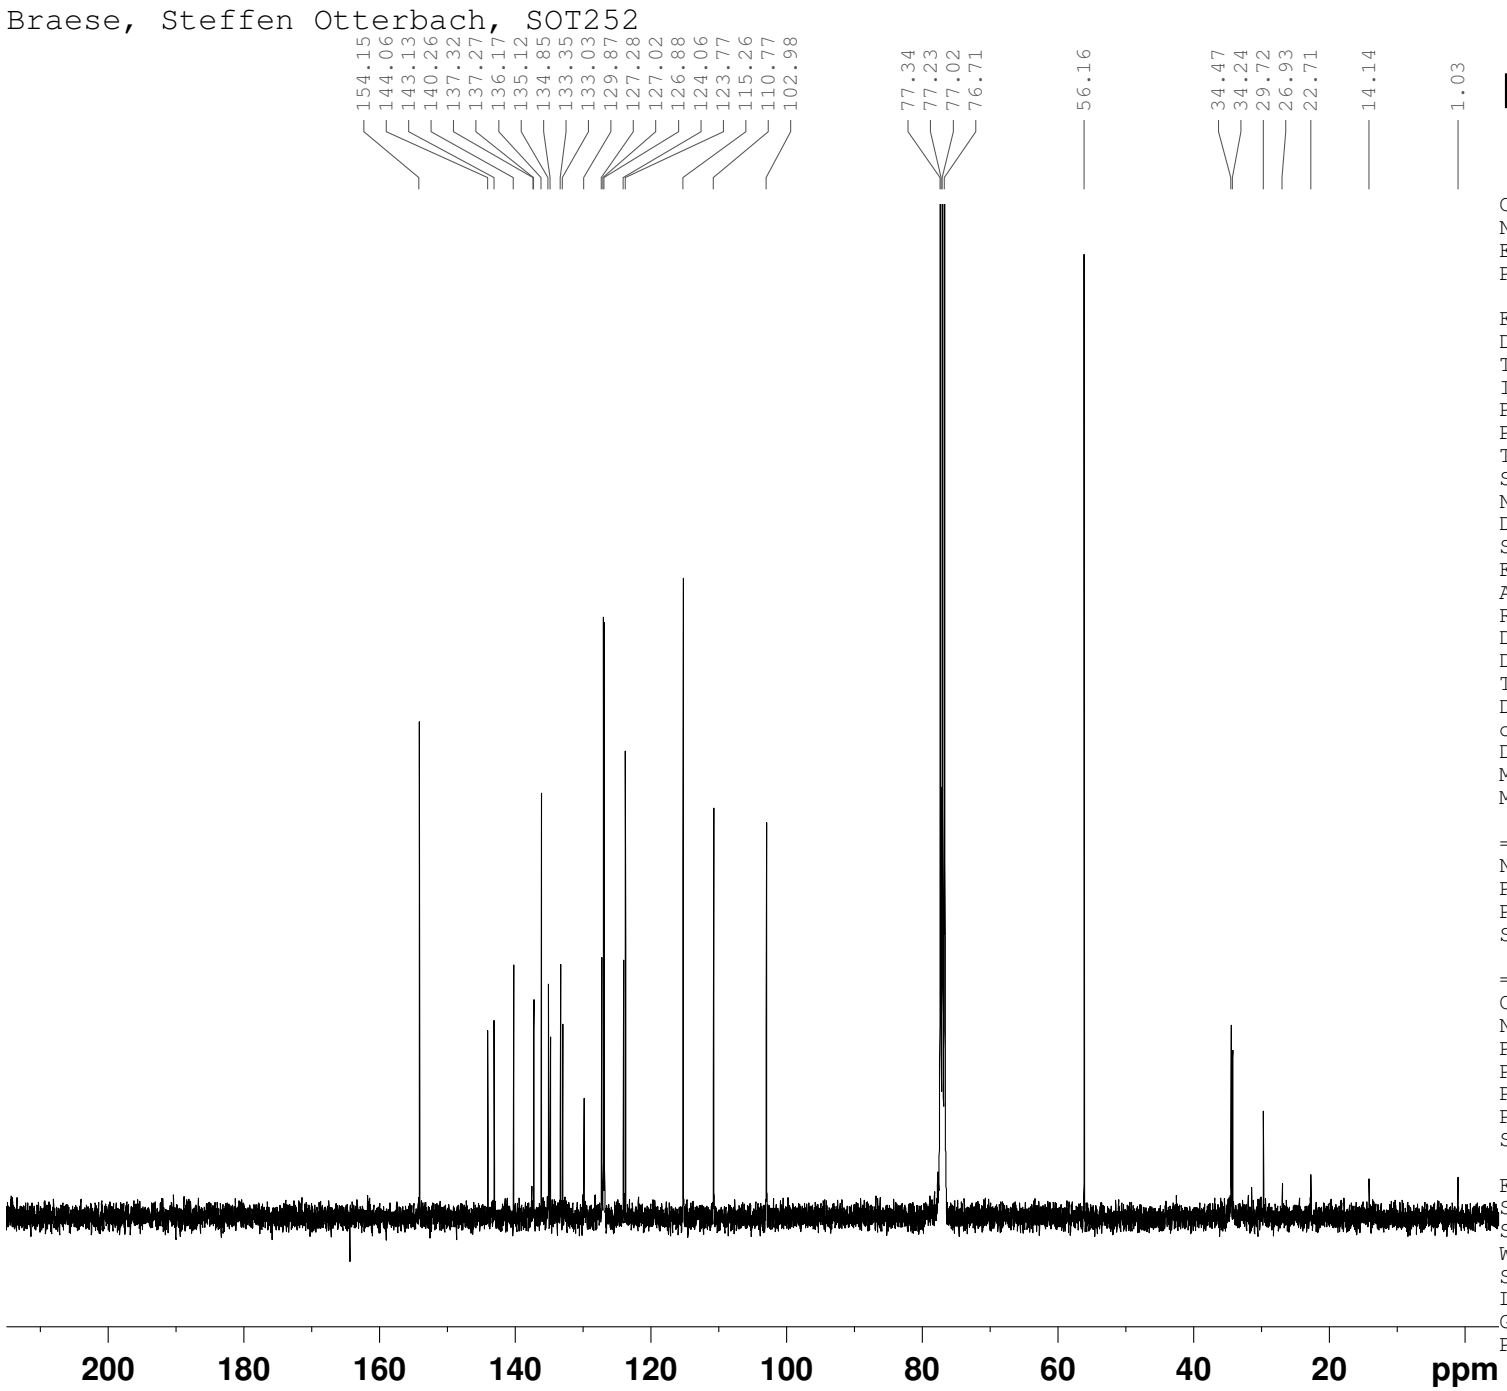

Current Data Parameters

NAME	Sep26-2022
EXPNO	61
PROCNO	1

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20220927
Time	21.41
INSTRUM	spect
PROBHD	5 mm PABBO BB-
PULPROG	zgpg30
TD	65536
SOLVENT	CDCl3
NS	8192
DS	2
SWH	23980.814 Hz
FIDRES	0.365918 Hz
AQ	1.3664756 sec
RG	2580.3
DW	20.850 usec
DE	6.00 usec
TE	300.0 K
D1	2.00000000 sec
d11	0.03000000 sec
DELTA	1.89999998 sec
MCREST	0.00000000 sec
MCWRK	0.01500000 sec

======== CHANNEL f1 ========

NUC1	13C
P1	10.00 usec
PL1	-2.00 dB
SFO1	100.6228298 MHz

======== CHANNEL f2 ========

CPDPRG2	waltz16
NUC2	1H
PCPD2	80.00 usec
PL2	-2.80 dB
PL12	12.19 dB
PL13	15.00 dB
SFO2	400.1316005 MHz

F2 - Processing parameters

SI	32768
SF	100.6127690 MHz
WDW	EM
SSB	0
LB	1.00 Hz
GB	0
PC	1.40