
AK Braese Steffen Otterbach SOT-237 CDCl3

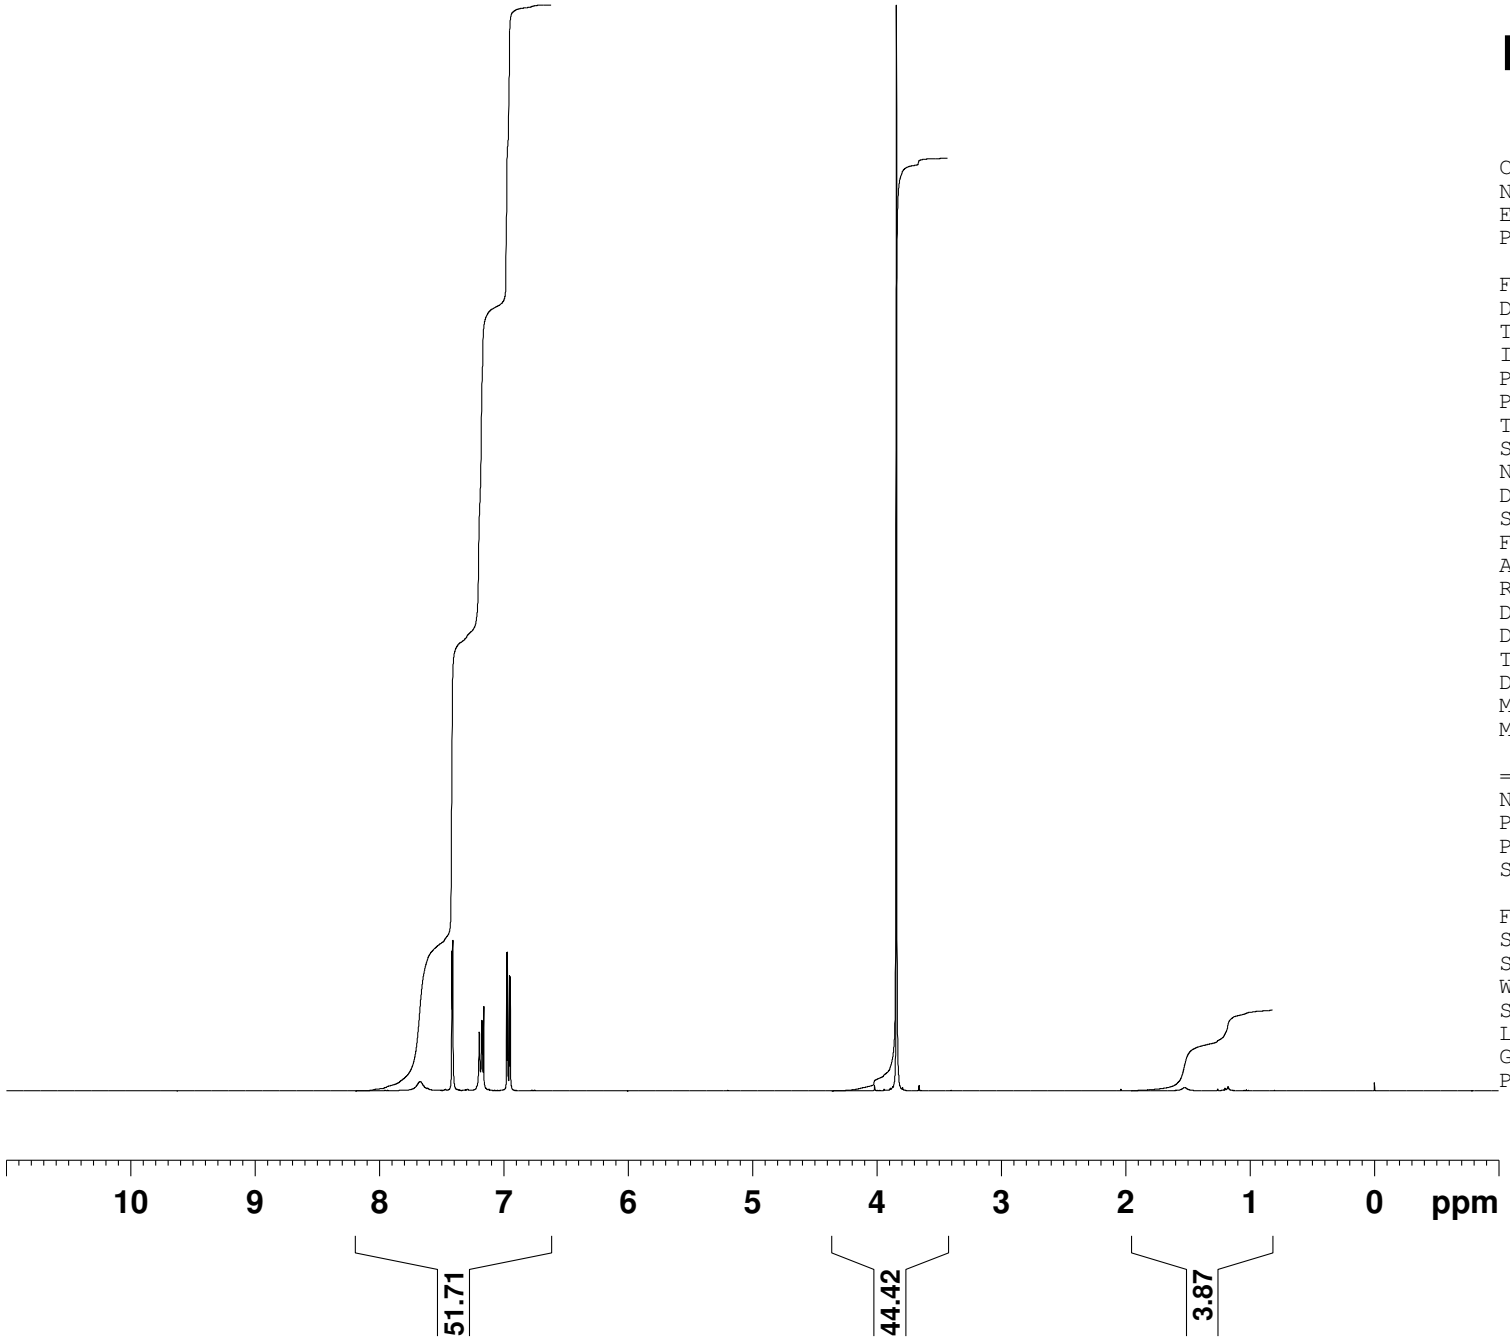

Current Data Parameters
NAME Sep23-2022
EXPNO 80
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20220924
Time 23.06
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm PABBO BB-
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 2
SWH 8278.146 Hz
FIDRES 0.126314 Hz
AQ 3.9584243 sec
RG 128
DW 60.400 usec
DE 6.00 usec
TE 300.0 K
D1 1.00000000 sec
MCREST 0.00000000 sec
MCWRK 0.01500000 sec

======== CHANNEL f1 ========
NUC1 1H
P1 14.25 usec
PL1 -2.80 dB
SFO1 400.1324710 MHz

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 400.1300470 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00