
AK braese, T.K?¶hler, KT-45

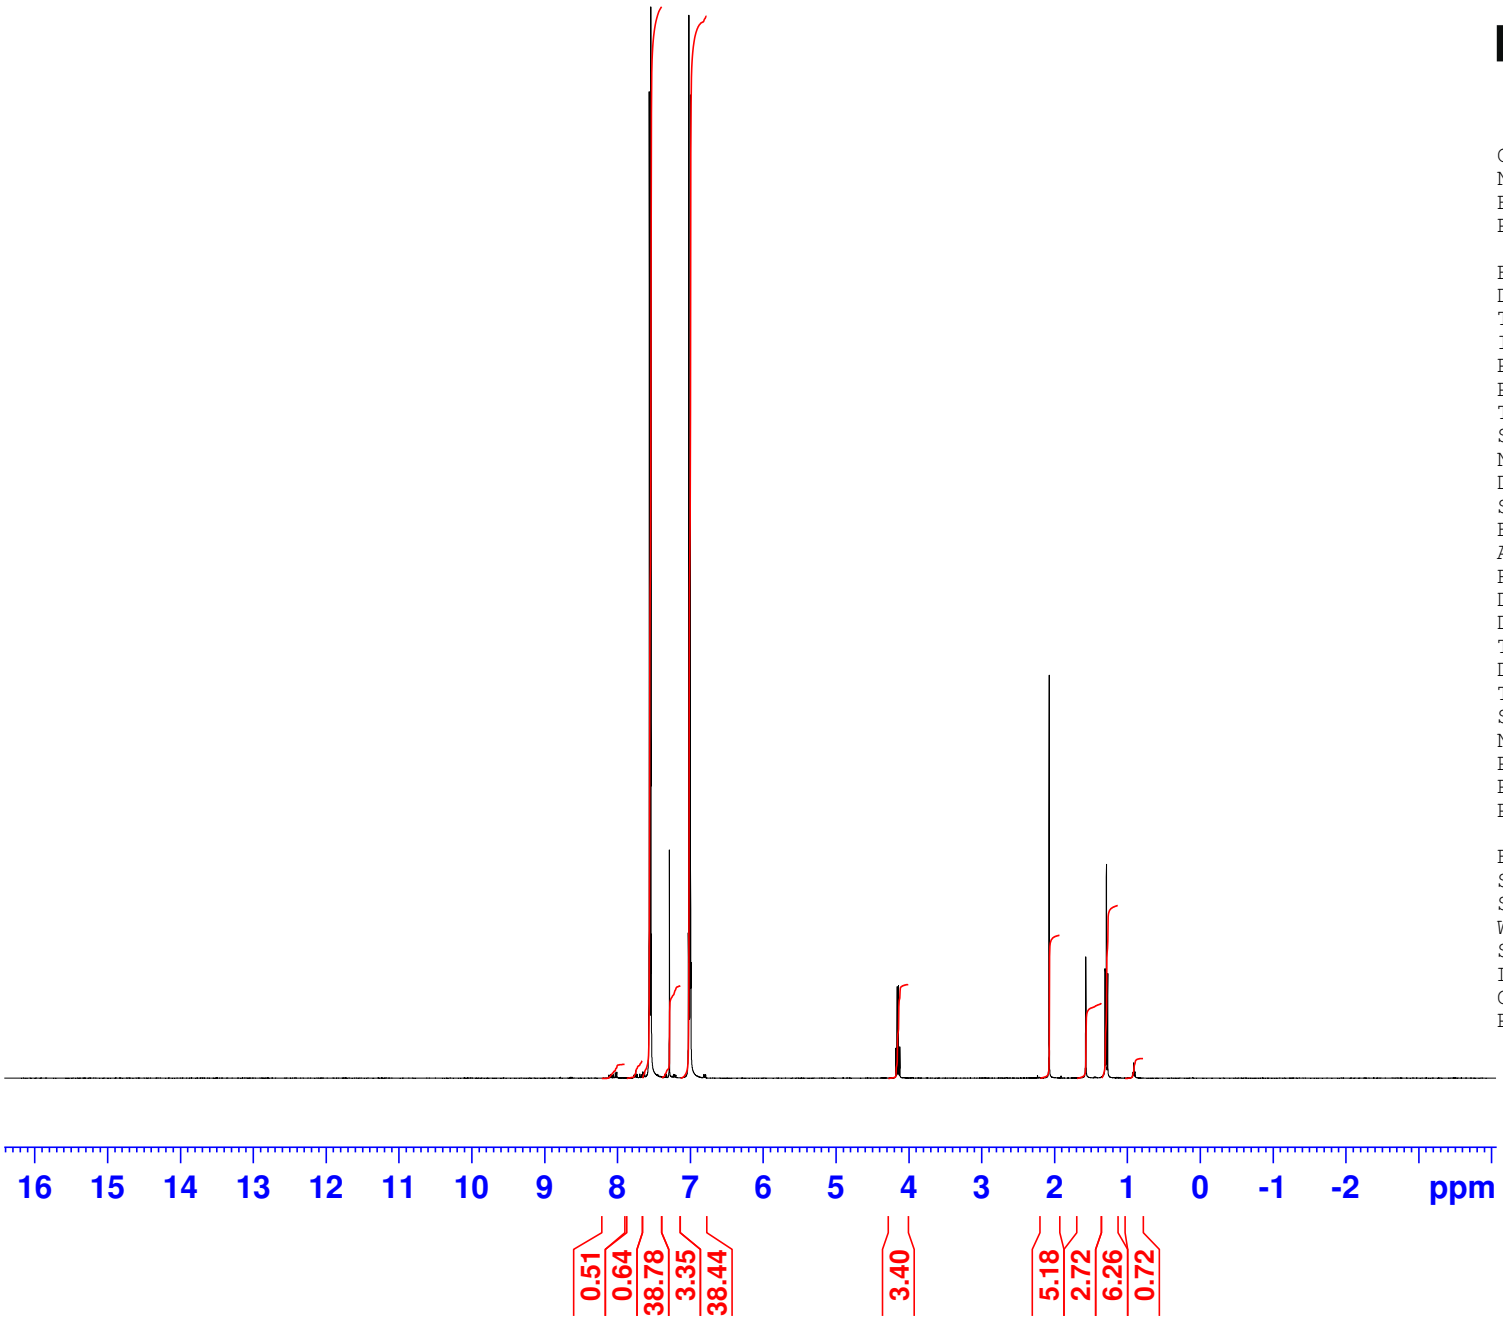

Current Data Parameters
NAME Feb02-2024
EXPNO 1070
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20240202
Time 17.25 h
INSTRUM Avance NEO
PROBHD Z116098_0874 (
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 2
SWH 8196.722 Hz
FIDRES 0.250144 Hz
AQ 3.9976959 sec
RG 101
DW 61.000 usec
DE 13.57 usec
TE 298.0 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 400.1324708 MHz
NUC1 1H
P0 3.27 usec
P1 9.82 usec
PLW1 16.00000000 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 400.1300000 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00