
AK braese, T.K?¶hler, KT-45

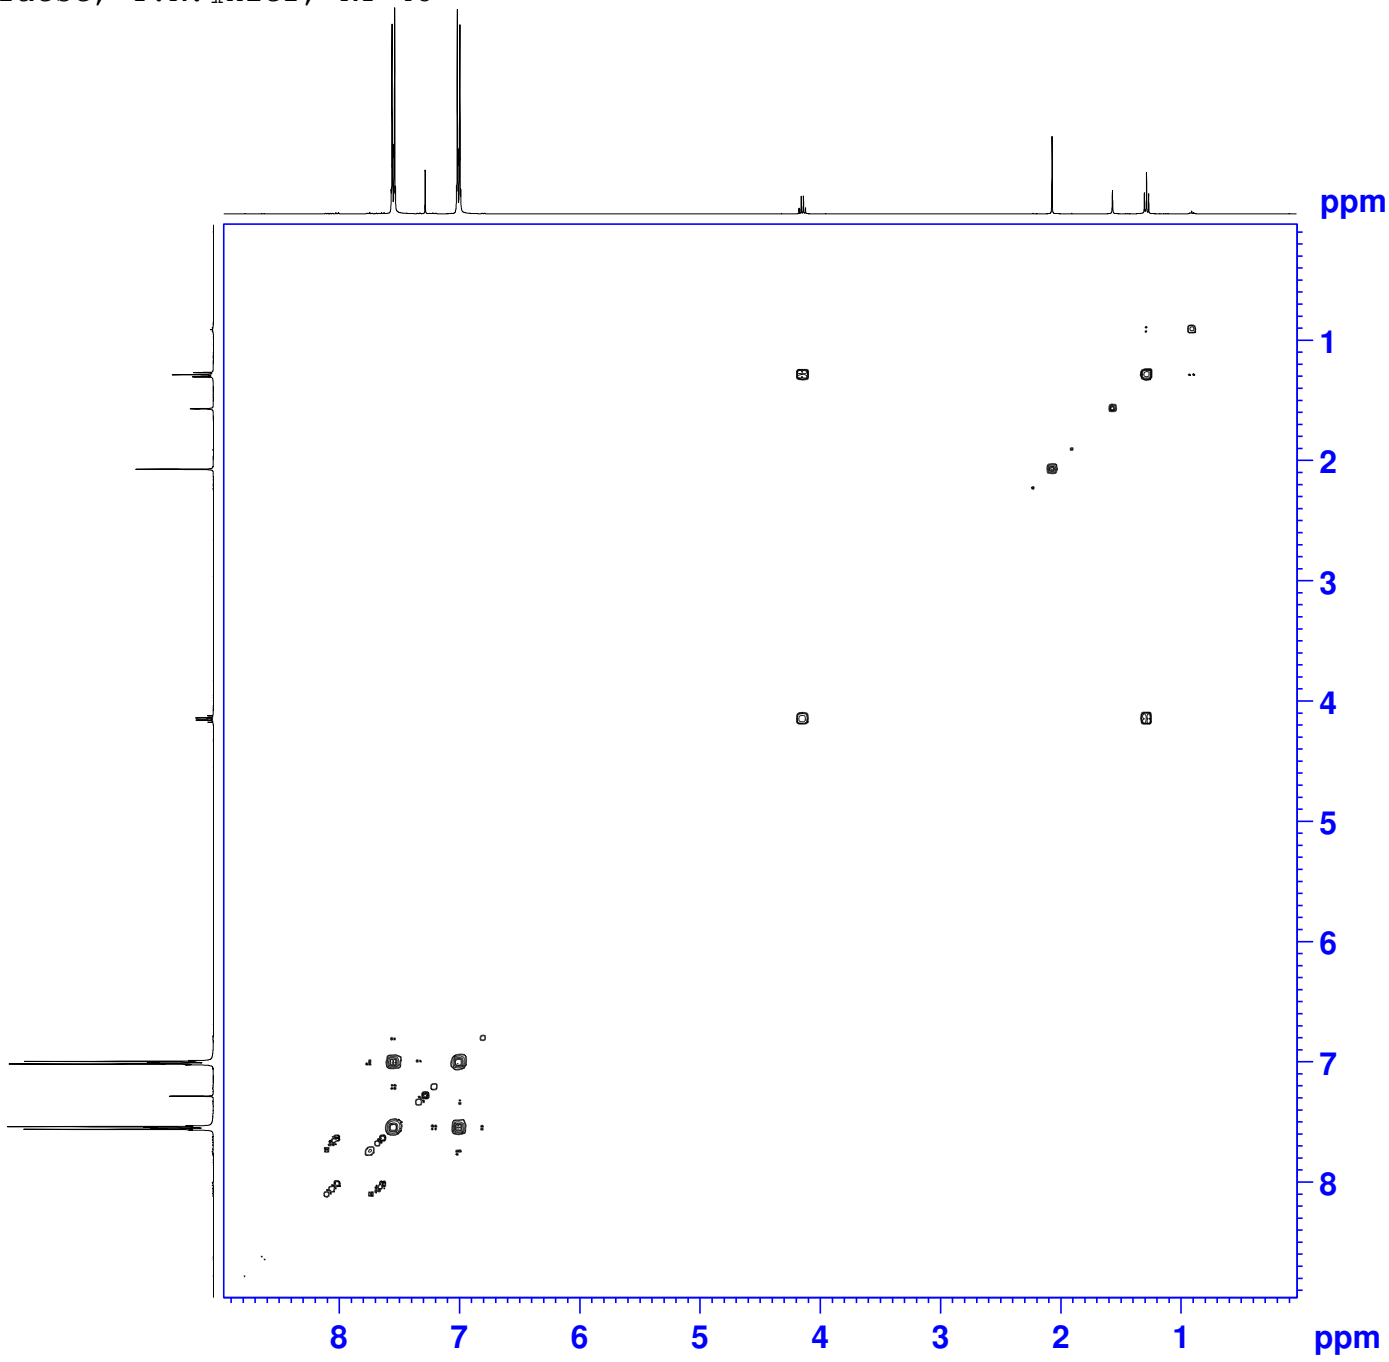


```
Current Data Parameters
NAME          Feb02-2024
EXPNO               1071
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20240202
Time               17.30 h
INSTRUM       Avance NEO
PROBHD    Z116098_0874 (
PULPROG       cosygpppqf
TD                  2048
SOLVENT            CDCl3
NS                     1
DS                    16
SWH             3571.428 Hz
FIDRES          3.487723 Hz
AQ              0.2867200 sec
RG                    64
DW                140.000 usec
DE                  6.50 usec
TE                 298.0 K
D0              0.00000300 sec
D1              1.90784001 sec
D11             0.03000000 sec
D12             0.00002000 sec
D13             0.00000400 sec
D16             0.00020000 sec
IN0             0.00028000 sec
TDav                   1
SFO1          400.1317998 MHz
NUC1                  1H
P0                  9.82 usec
P1                  9.82 usec
P17              2500.00 usec
PLW1          16.00000000 W
PLW10          1.71440005 W
GPNAM[1]      SMSQ10.100
GPZ1              10.00 %
P16             1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD                   128
SFO1            400.1318 MHz
FIDRES         55.803570 Hz
SW                 8.926 ppm
FnMODE                QF

F2 - Processing parameters
SI                  1024
SF           400.1300000 MHz
WDW                 QSINE
SSB       0
LB        0 Hz
GB        0
PC                  1.40

F1 - Processing parameters
SI                  1024
MC2                   QF
SF           400.1300000 MHz
WDW                 QSINE
SSB       0
LB        0 Hz
GB        0
```