
AK braese, T.K?¶hler, KT-45

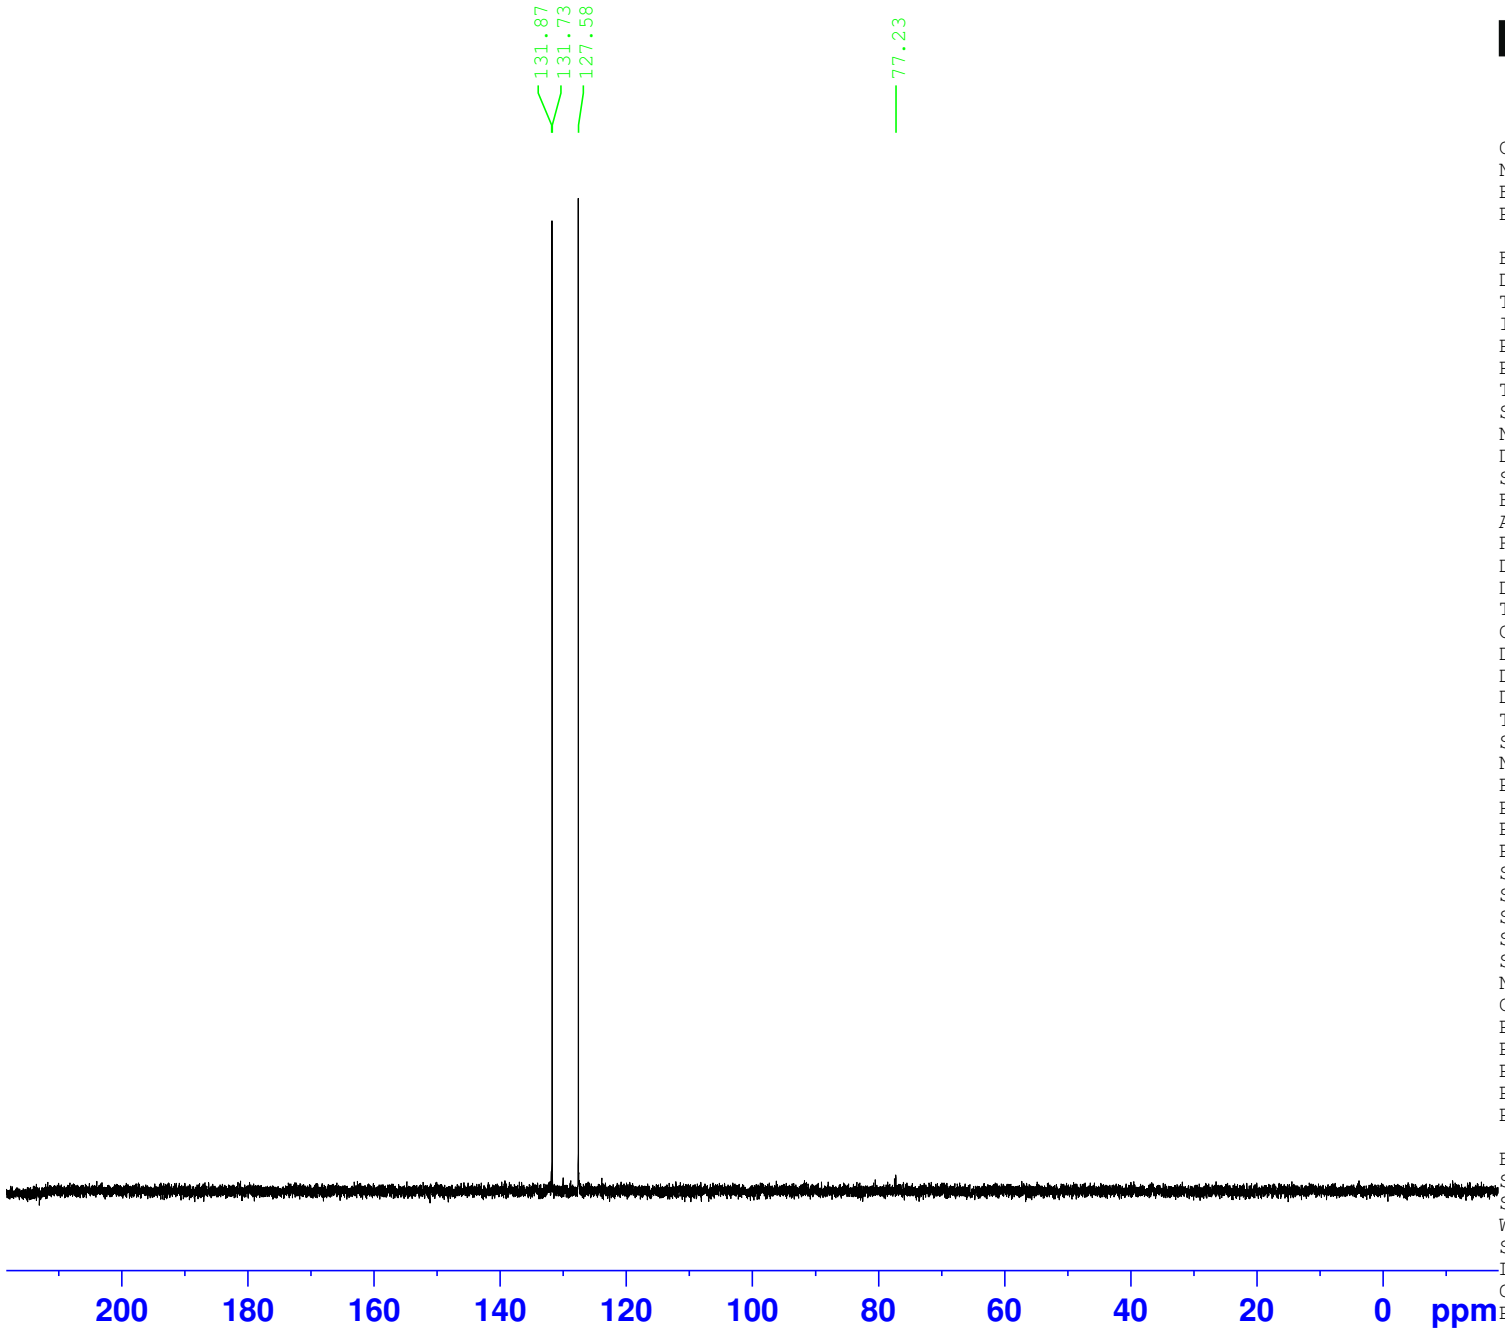

Current Data Parameters
NAME Feb02-2024
EXPNO 1073
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20240204
Time 2.25 h
INSTRUM Avance NEO
PROBHD Z116098_0874 (
PULPROG deptsp90
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 256
DS 8
SWH 23809.523 Hz
FIDRES 0.726609 Hz
AQ 1.3762560 sec
RG 101
DW 21.000 usec
DE 6.50 usec
TE 298.0 K
CNST2 145.0000000
D1 2.00000000 sec
D2 0.00344828 sec
D12 0.00002000 sec
TD0 1
SFO1 100.6228298 MHz
NUC1 13C
P1 10.00 usec
P13 2000.00 usec
PLW0 0 W
PLW1 69.81300354 W
SPNAM[5] Crp60comp.4
SPOAL5 0.500
SPOFFS5 0 Hz
SPW5 10.66699982 W
SFO2 400.1316005 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz65
P3 9.82 usec
P4 19.64 usec
PCPD2 90.00 usec
PLW2 16.00000000 W
PLW12 0.19047999 W

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 100.6127685 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40