
HMBC.icon CDCl3 {D:\Data\Hall} Hunt 18

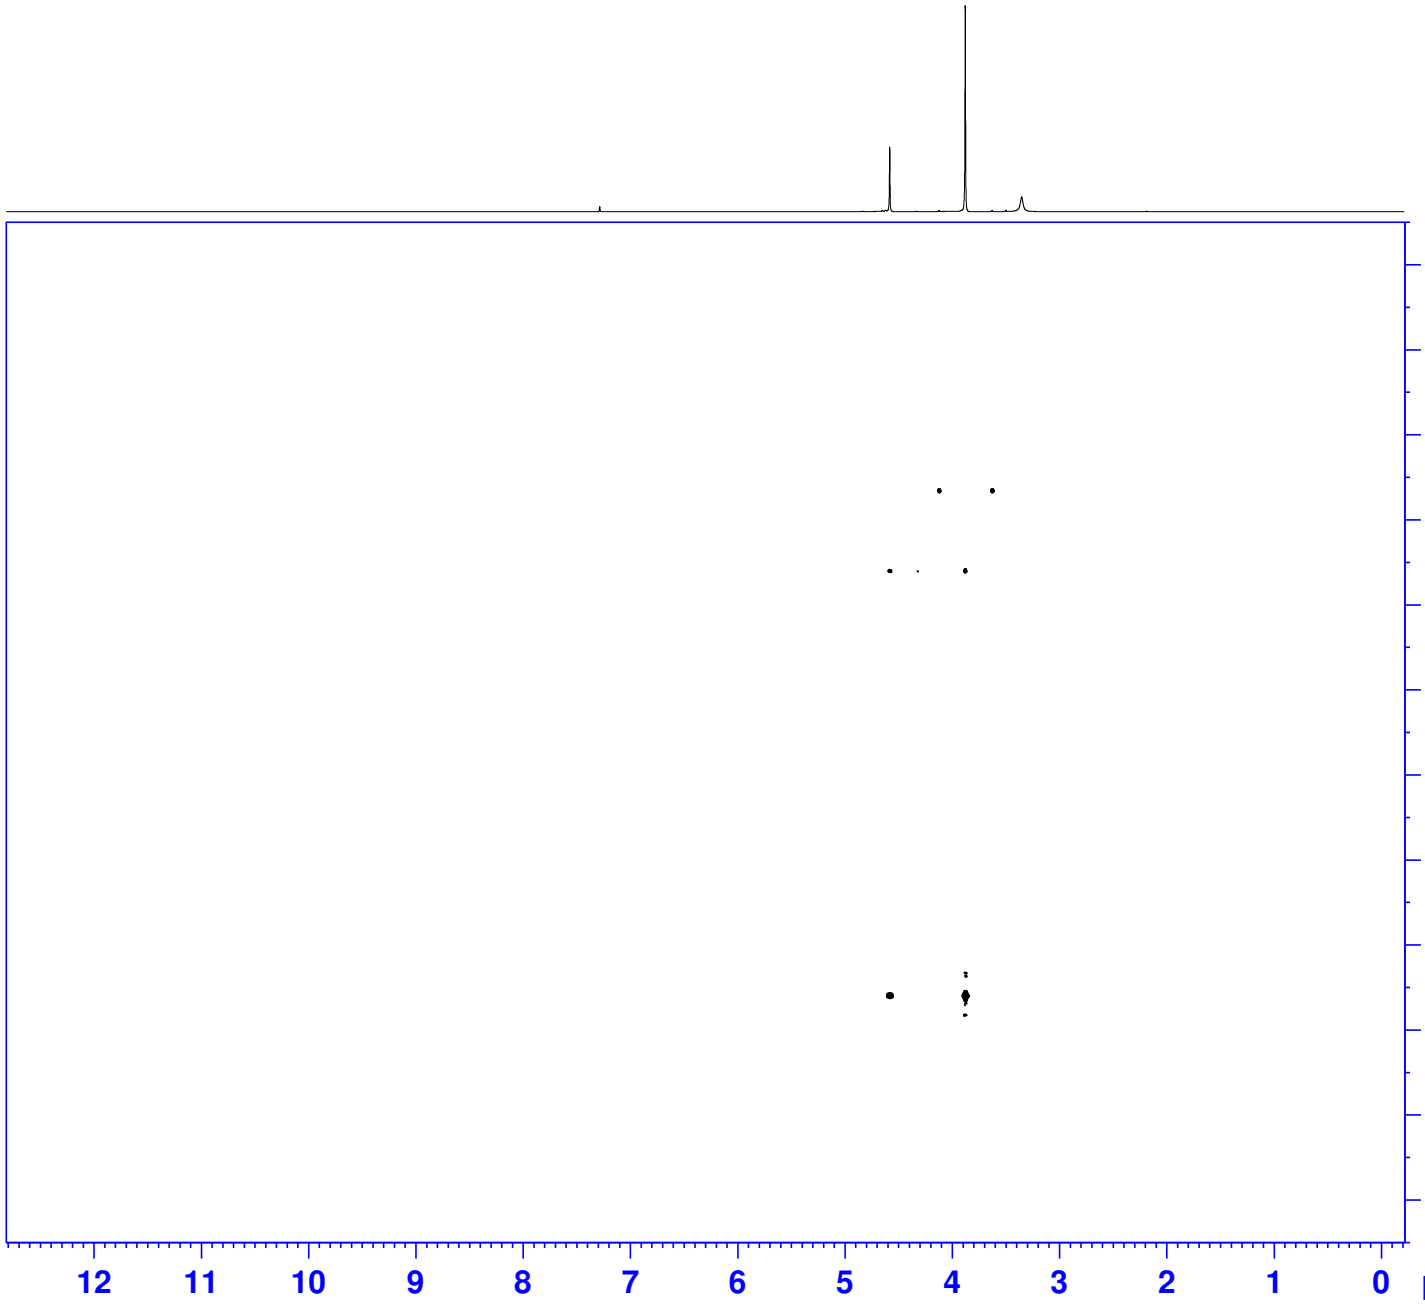

Current Data Parameters
NAME GH_608-68-4_CDCl3_full
EXPNO 7
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20240620
Time 21.05 h
INSTRUM AVIII300
PROBHD Z104275_0301 (
PULPROG hmbcetgpl3nd
TD 4096
SOLVENT CDCl3
NS 4
DS 16
SWH 3912.363 Hz
FIDRES 1.910334 Hz
AQ 0.5234688 sec
RG 2050
DW 127.800 usec
DE 6.50 usec
TE 298.0 K
CNST6 120.0000000
CNST7 175.0000000
CNST13 8.0000000
D0 0.00000300 sec
D1 1.50000000 sec
D6 0.06250000 sec
D16 0.00020000 sec
IN0 0.00002760 sec
TDav 1
SFO1 300.1318908 MHz
NUC1 1H
P1 13.25 usec
P2 26.50 usec
PLW1 7.62960005 W
SFO2 75.4760490 MHz
NUC2 13C
P3 9.20 usec
P24 2000.00 usec
PLW2 39.70000076 W
SPNAM[7] Crp60comp.4
SPOAL7 0.500
SPOFFS7 0 Hz
SPW7 5.13399982 W
GPNAM[1] SMSQ10.100
GPZ1 80.00 %
GPNAM[3] SMSQ10.100
GPZ3 14.00 %
GPNAM[4] SMSQ10.100
GPZ4 -8.00 %
GPNAM[5] SMSQ10.100
GPZ5 -4.00 %
GPNAM[6] SMSQ10.100
GPZ6 -2.00 %
P16 1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD 512
SFO1 75.47605 MHz
FIDRES 70.765396 Hz
SW 240.022 ppm
FnMODE Echo-Antiecho

F2 - Processing parameters
SI 4096
SF 300.1300000 MHz
WDW QSINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0
PC 1.40

F1 - Processing parameters
SI 1024
MC2 echo-antiecho
SF 75.4677485 MHz
WDW QSINE
SSB 2
LB 0 Hz
GB 0