
COSYGPSW CDCl3 {D:\Data\Hall} Hunt 15

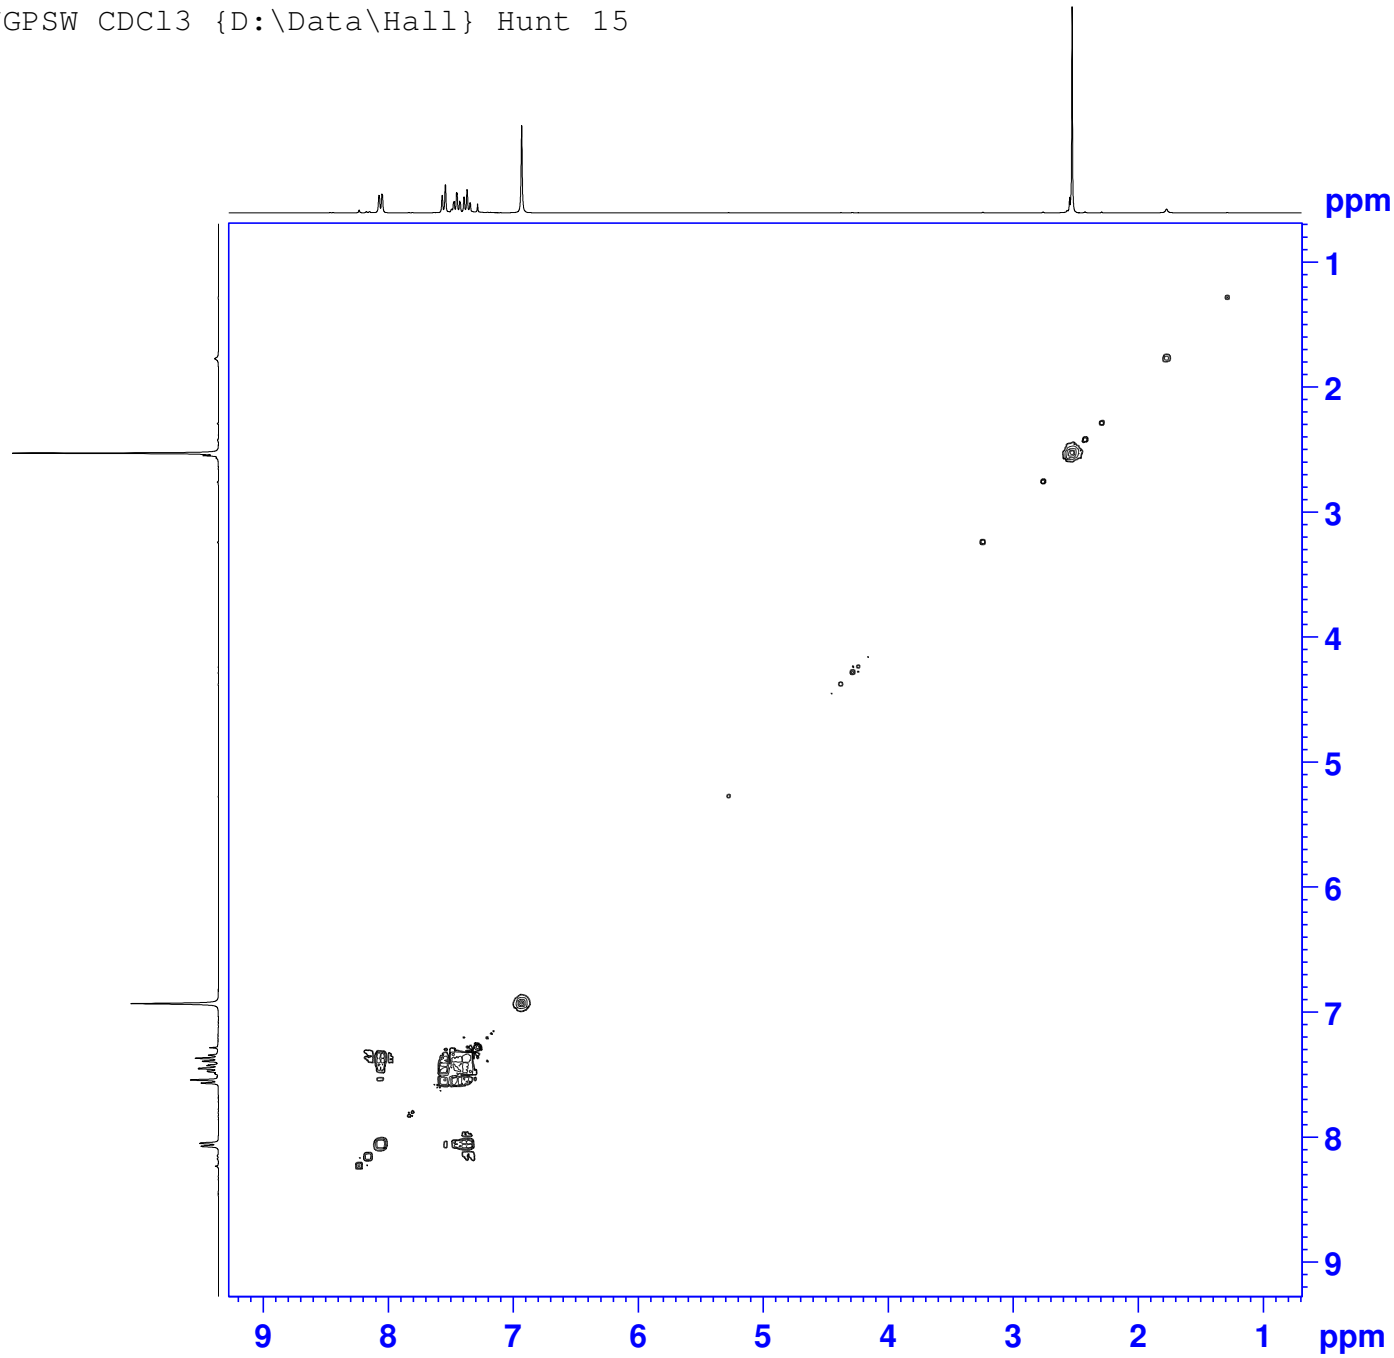

Current Data Parameters
NAME GH_168618-42-6_CDCl3
EXPNO 4
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20240710
Time 13.40 h
INSTRUM AVIII300
PROBHD Z104275_0301 (
PULPROG cosygpppqf
TD 2048
SOLVENT CDCl3
NS 1
DS 16
SWH 2577.320 Hz
FIDRES 2.516914 Hz
AQ 0.3973120 sec
RG 63.15
DW 194.000 usec
DE 6.50 usec
TE 298.0 K
D0 0.00000300 sec
D1 1.84080195 sec
D11 0.03000000 sec
D12 0.00002000 sec
D13 0.00000400 sec
D16 0.00020000 sec
IN0 0.00038800 sec
TDav 1
SFO1 300.1314955 MHz
NUC1 1H
P0 13.25 usec
P1 13.25 usec
P17 2500.00 usec
PLW1 7.62960005 W
PLW10 1.48829997 W
GPNAM[1] SMSQ10.100
GPZ1 10.00 %
P16 1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD 128
SFO1 300.1315 MHz
FIDRES 40.270618 Hz
SW 8.587 ppm
FnMODE QF

F2 - Processing parameters
SI 1024
SF 300.1300000 MHz
WDW QSINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0
PC 1.40

F1 - Processing parameters
SI 1024
MC2 QF
SF 300.1300000 MHz
WDW QSINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0