
AK Br?¤se, J.Hofmann, JSH-R53, Full2 dept90

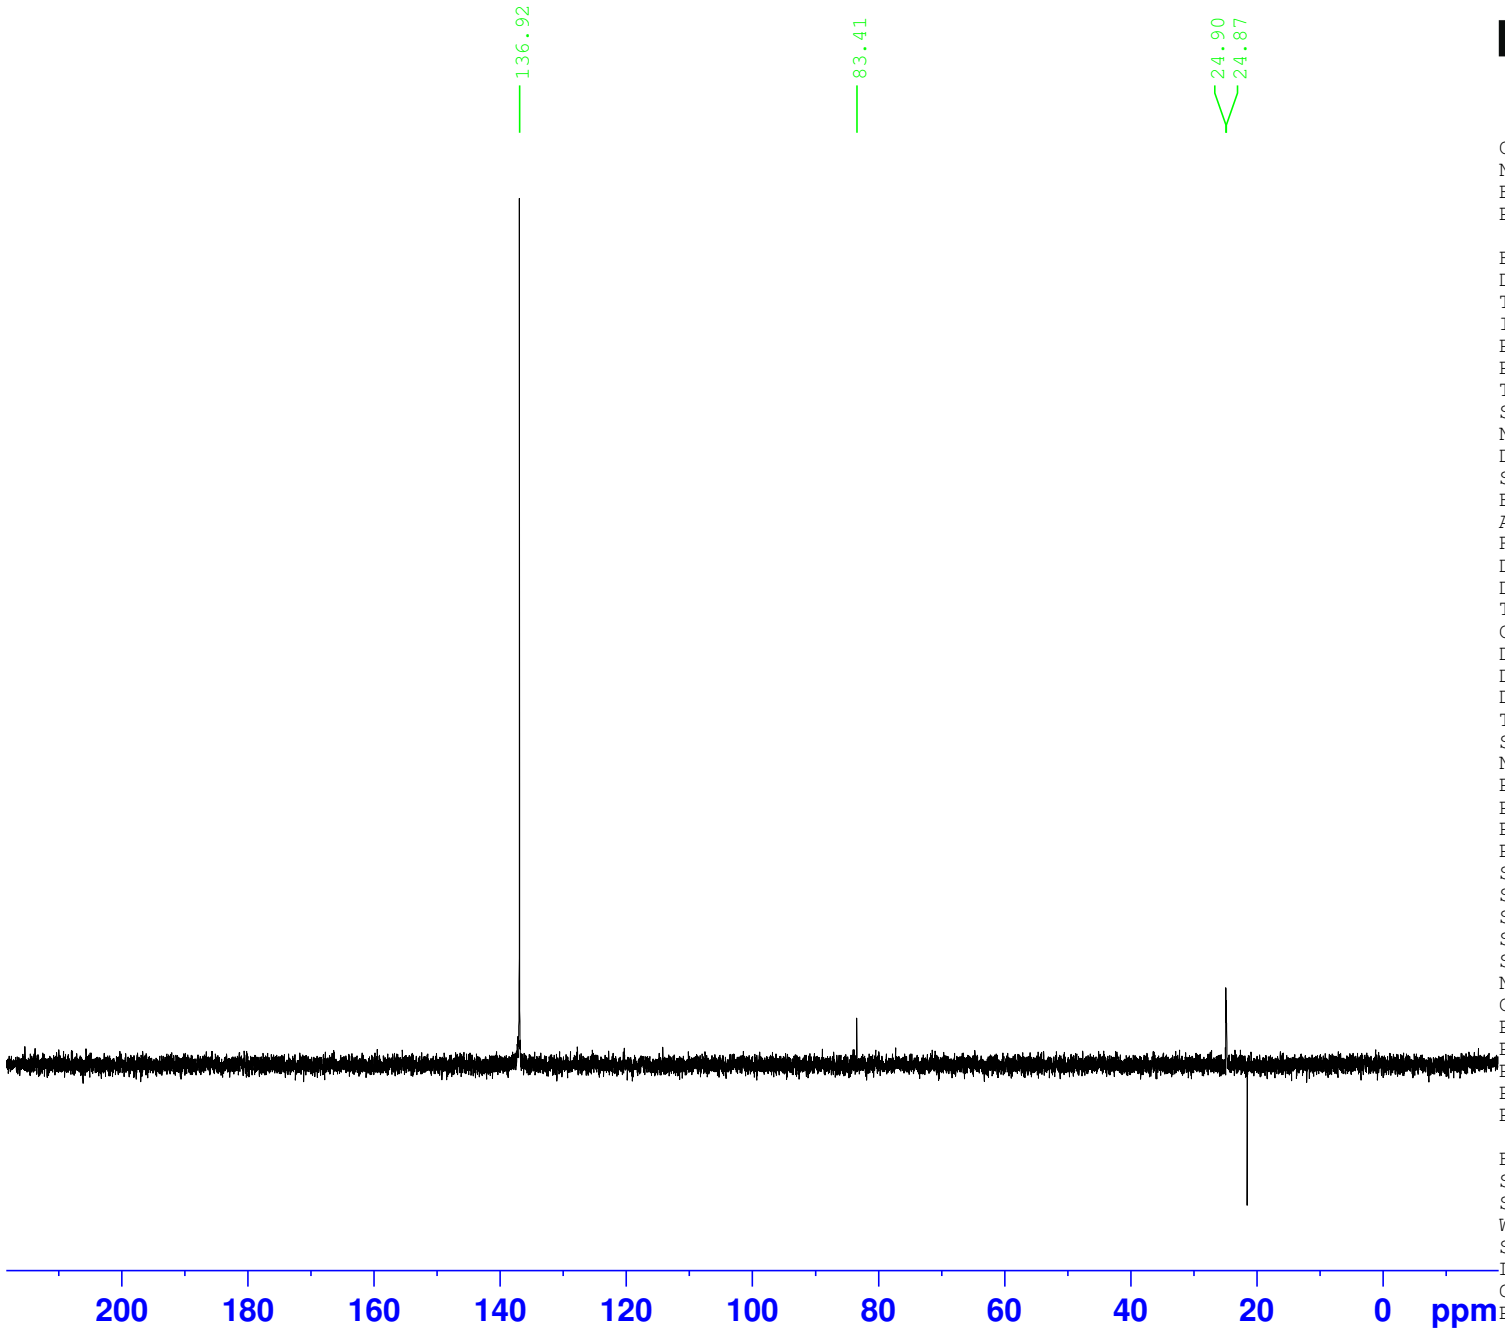


```
Current Data Parameters
NAME          Sep16-2024
EXPNO                 53
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20240916
Time              21.21 h
INSTRUM       Avance NEO
PROBHD    Z116098_0874 (
PULPROG         deptsp90
TD                65536
SOLVENT            CDCl3
NS                   256
DS                     8
SWH            23809.523 Hz
FIDRES          0.726609 Hz
AQ             1.3762560 sec
RG                   101
DW                21.000 usec
DE                 6.50 usec
TE                297.3 K
CNST2        145.0000000
D1            2.00000000 sec
D2            0.00344828 sec
D12           0.00002000 sec
TD0                    1
SFO1         100.6228298 MHz
NUC1                 13C
P1                10.00 usec
P13             2000.00 usec
PLW0      0 W
PLW1         69.81300354 W
SPNAM[5]    Crp60comp.4
SPOAL5             0.500
SPOFFS5   0 Hz
SPW5         10.66699982 W
SFO2         400.1316005 MHz
NUC2                 1H
CPDPRG[2         waltz65
P3                10.03 usec
P4                20.06 usec
PCPD2             90.00 usec
PLW2         16.00000000 W
PLW12         0.19871999 W

F2 - Processing parameters
SI                32768
SF           100.6127685 MHz
WDW                  EM
SSB       0
LB                 1.00 Hz
GB        0
PC                 1.40
```