
AK Br?¤se, J.Hofmann, JSH-R53, Full2 dept 135

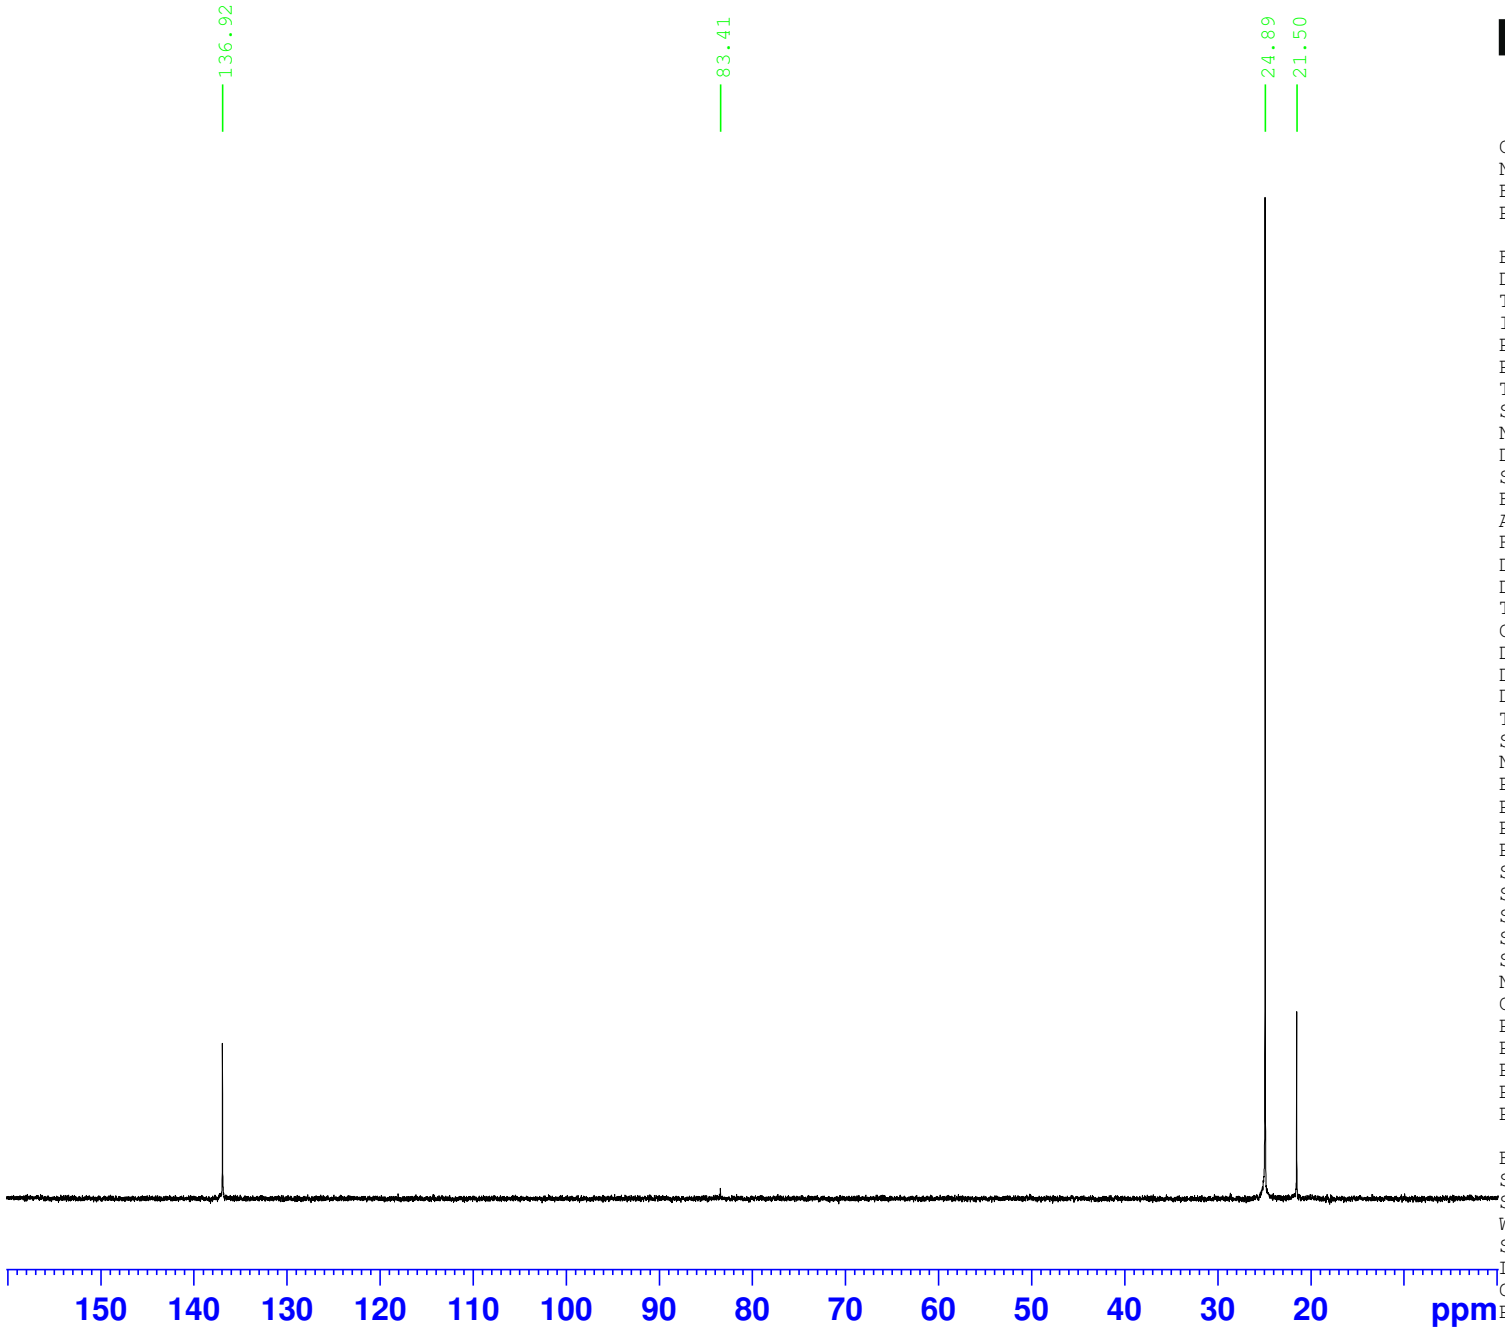

Current Data Parameters
NAME Sep16-2024
EXPNO 54
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20240916
Time 21.40 h
INSTRUM Avance NEO
PROBHD Z116098_0874 (
PULPROG deptsp135
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 256
DS 8
SWH 16129.032 Hz
FIDRES 0.492219 Hz
AQ 2.0316160 sec
RG 101
DW 31.000 usec
DE 6.50 usec
TE 297.5 K
CNST2 145.0000000
D1 2.00000000 sec
D2 0.00344828 sec
D12 0.00002000 sec
TD0 1
SFO1 100.6208175 MHz
NUC1 13C
P1 10.00 usec
P13 2000.00 usec
PLW0 0 W
PLW1 69.81300354 W
SPNAM[5] Crp60comp.4
SPOAL5 0.500
SPOFFS5 0 Hz
SPW5 10.66699982 W
SFO2 400.1316005 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz65
P3 10.03 usec
P4 20.06 usec
PCPD2 90.00 usec
PLW2 16.00000000 W
PLW12 0.19871999 W

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 100.6127685 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40