
AK Br?¤se, J.Hofmann, JSH-R62 full dept 135

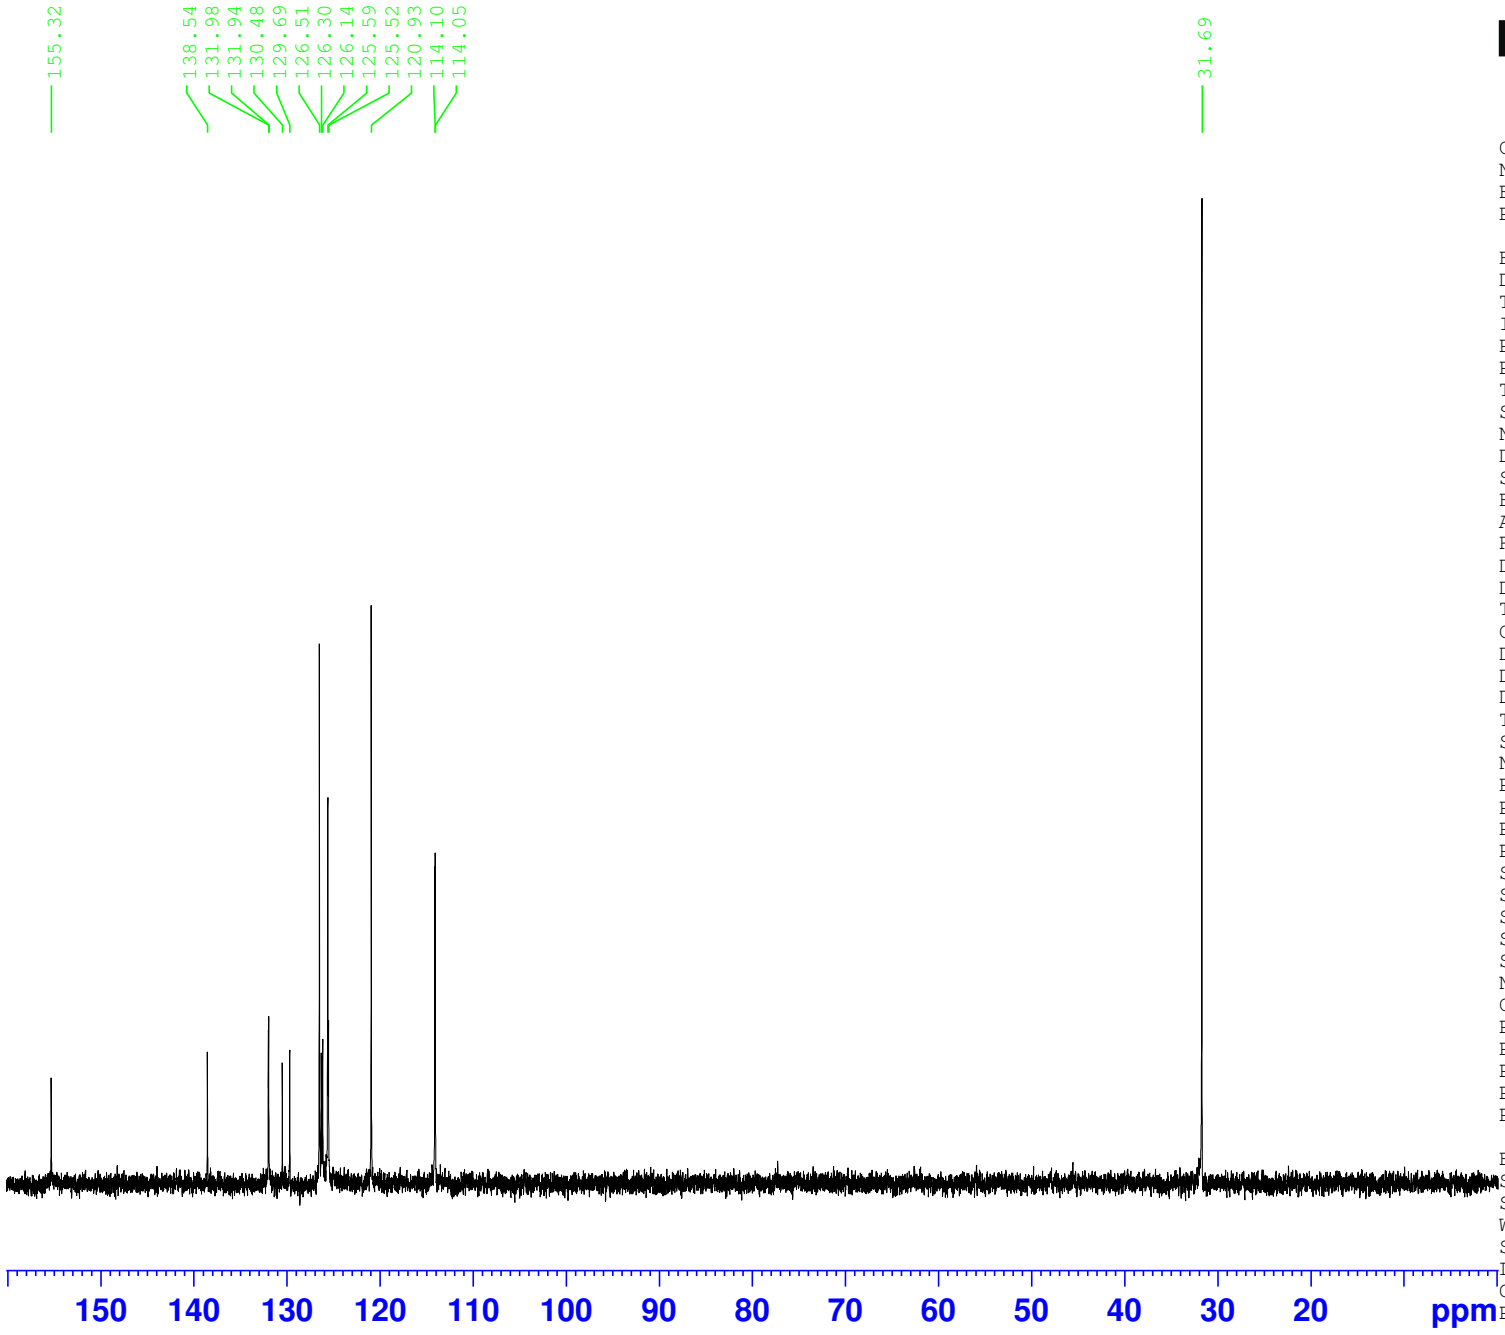

Current Data Parameters

NAME	Sep12-2024	
EXPNO	224	
PROCNO	1	

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20240913	
Time	5.52	h
INSTRUM	Avance NEO	
PROBHD	Z116098_0874 (	
PULPROG	deptsp135	
TD	65536	
SOLVENT	CDCl3	
NS	256	
DS	8	
SWH	16129.032	Hz
FIDRES	0.492219	Hz
AQ	2.0316160	sec
RG	101	
DW	31.000	usec
DE	6.50	usec
TE	296.2	K
CNST2	145.0000000	
D1	2.00000000	sec
D2	0.00344828	sec
D12	0.00002000	sec
TD0	1	
SFO1	100.6208175	MHz
NUC1	13C	
P1	10.00	usec
P13	2000.00	usec
PLW0	0 W	
PLW1	69.81300354	W
SPNAM[5]	Crp60comp.4	
SPOAL5	0.500	
SPOFFS5	0 Hz	
SPW5	10.66699982	W
SFO2	400.1316005	MHz
NUC2	1H	
CPDPRG[2	waltz65	
P3	10.56	usec
P4	21.12	usec
PCPD2	90.00	usec
PLW2	16.00000000	W
PLW12	0.22026999	W

F2 - Processing parameters

SI	32768	
SF	100.6127685	MHz
WDW	EM	
SSB	0	
LB	1.00	Hz
GB	0	
PC	1.40	