
C13CPD CDCl3 C:\\ Conrads 2

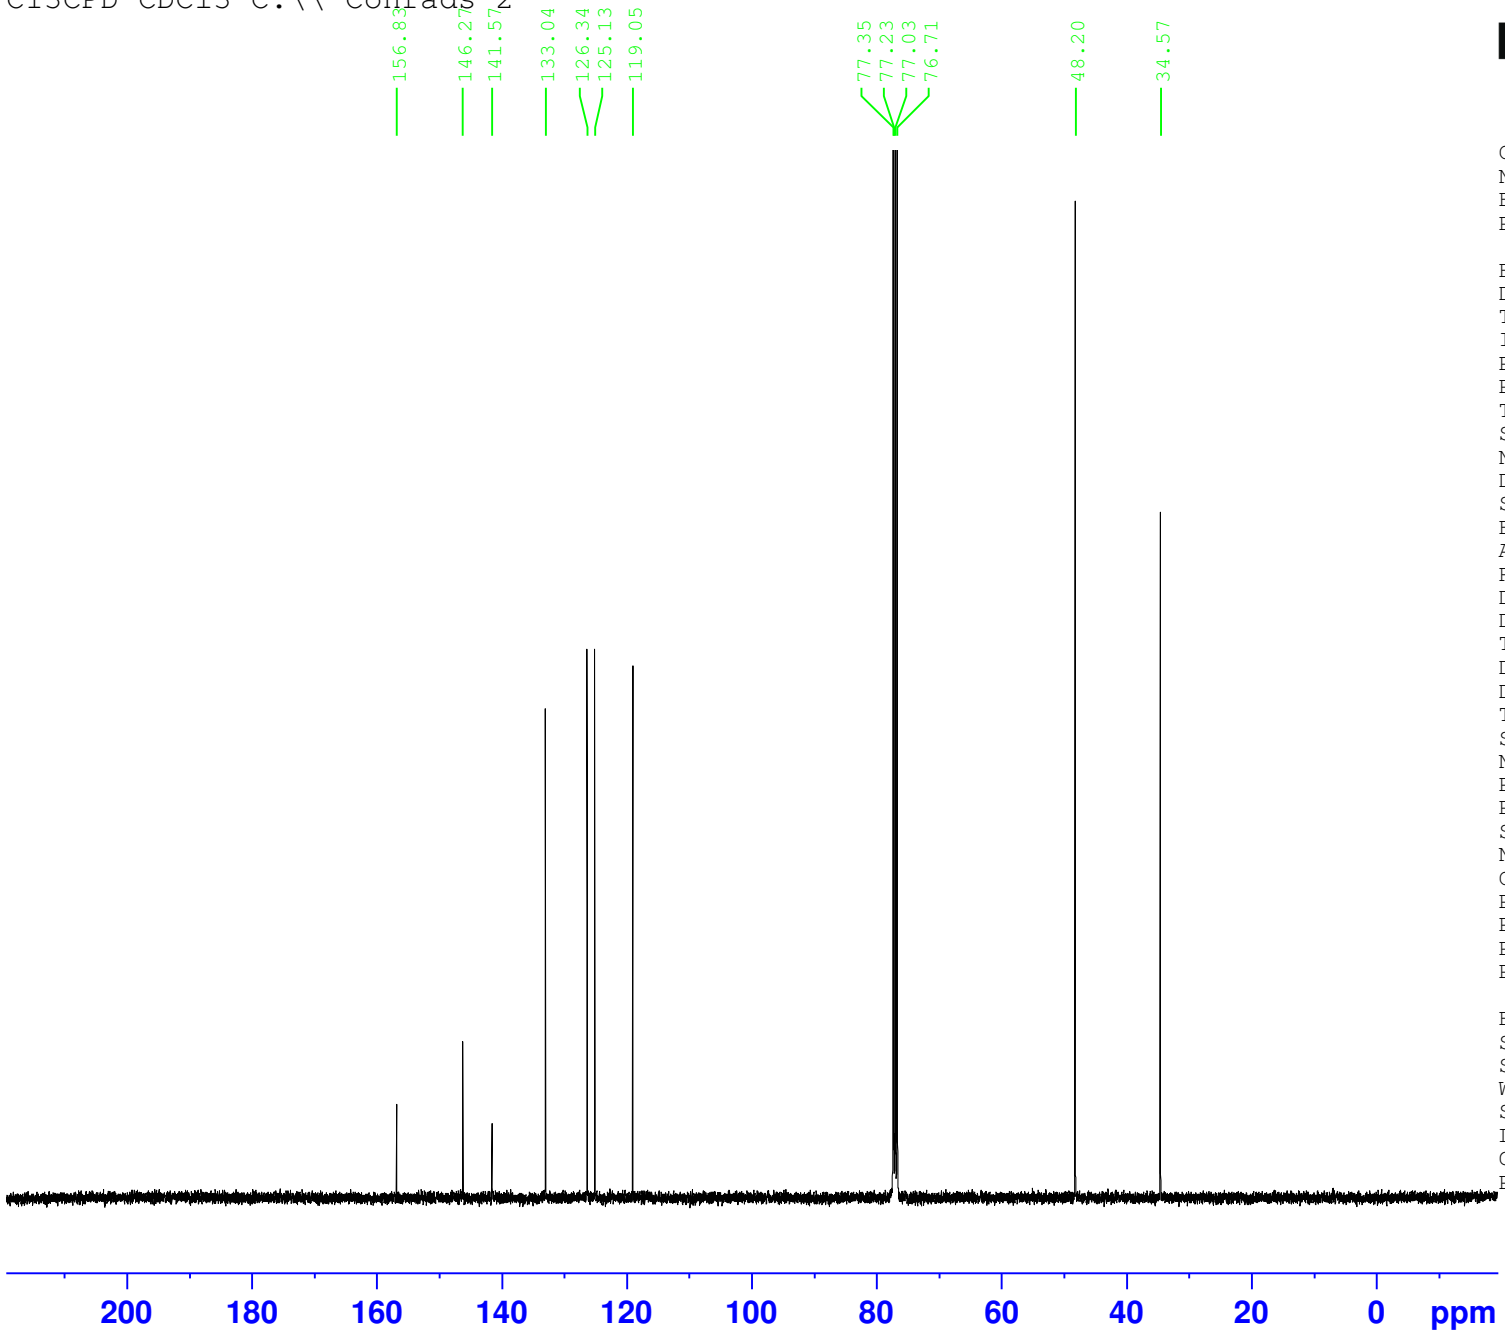

Current Data Parameters
NAME CC-273-4
EXPNO 12
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20220113
Time 20.05 h
INSTRUM spect
PROBHD Z108618_0644 (
PULPROG zgpg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 1024
DS 4
SWH 24038.461 Hz
FIDRES 0.733596 Hz
AQ 1.3631488 sec
RG 198.07
DW 20.800 usec
DE 6.50 usec
TE 300.7 K
D1 2.00000000 sec
D11 0.03000000 sec
TD0 1
SFO1 100.6655806 MHz
NUC1 13C
P1 10.00 usec
PLW1 49.00000000 W
SFO2 400.3016012 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz16
PCPD2 90.00 usec
PLW2 10.50000000 W
PLW12 0.25845000 W
PLW13 0.13000000 W

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 100.6555150 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40